

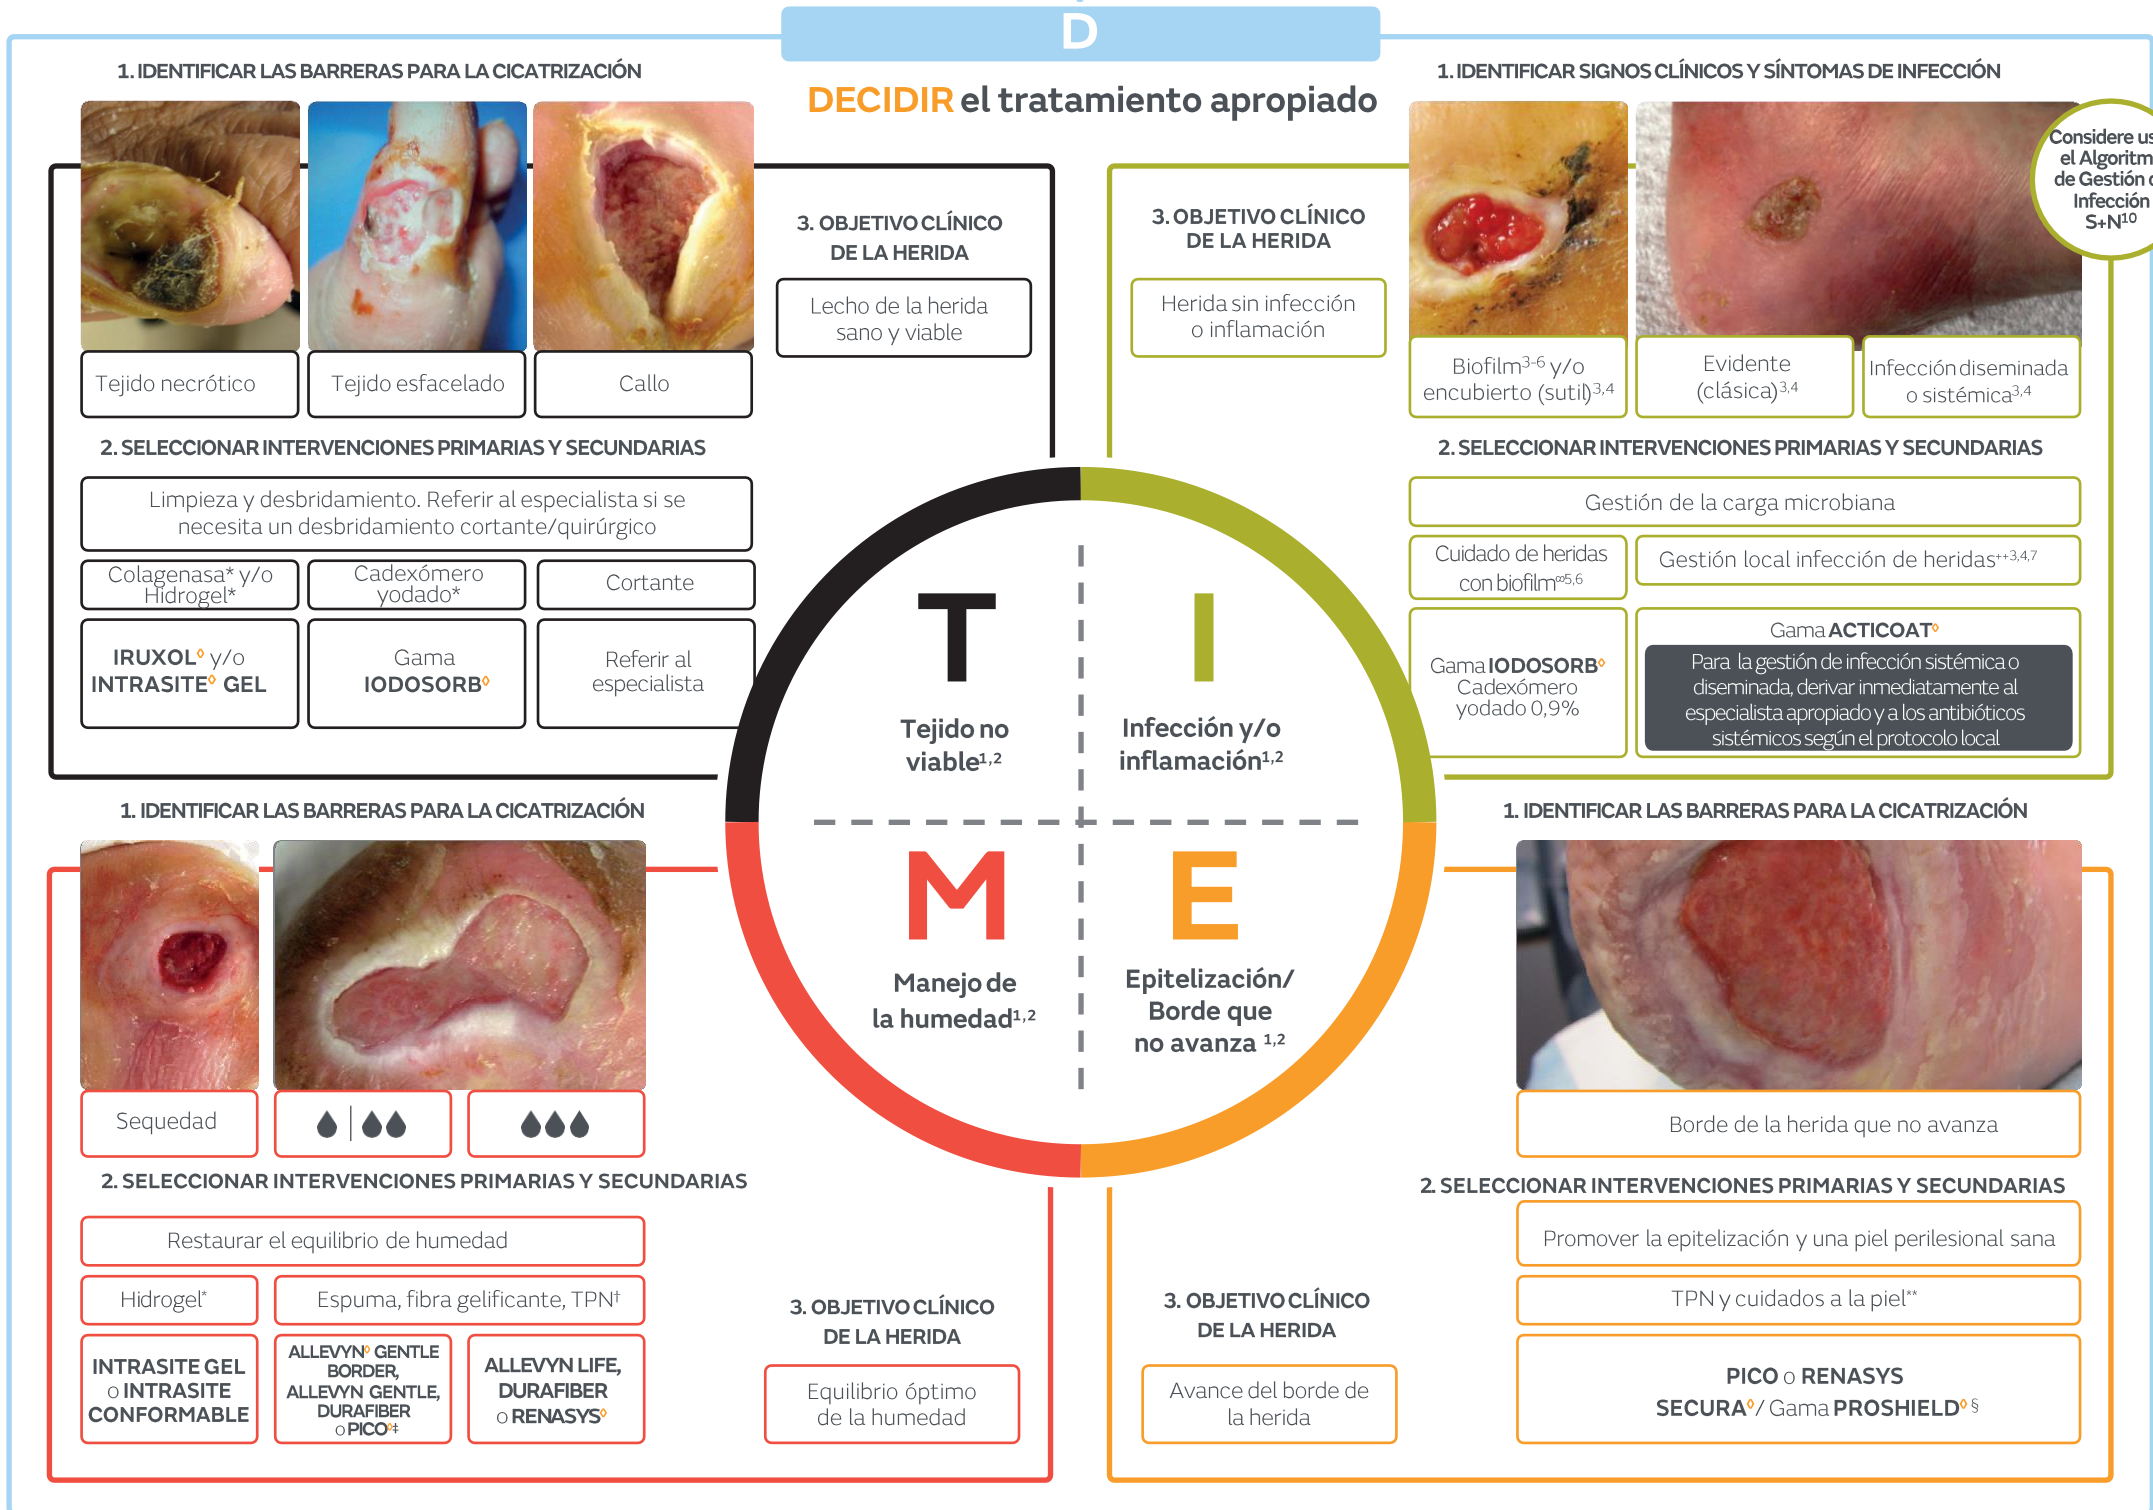


Úlcera de pie diabético

EMPIECE AQUÍ ↓

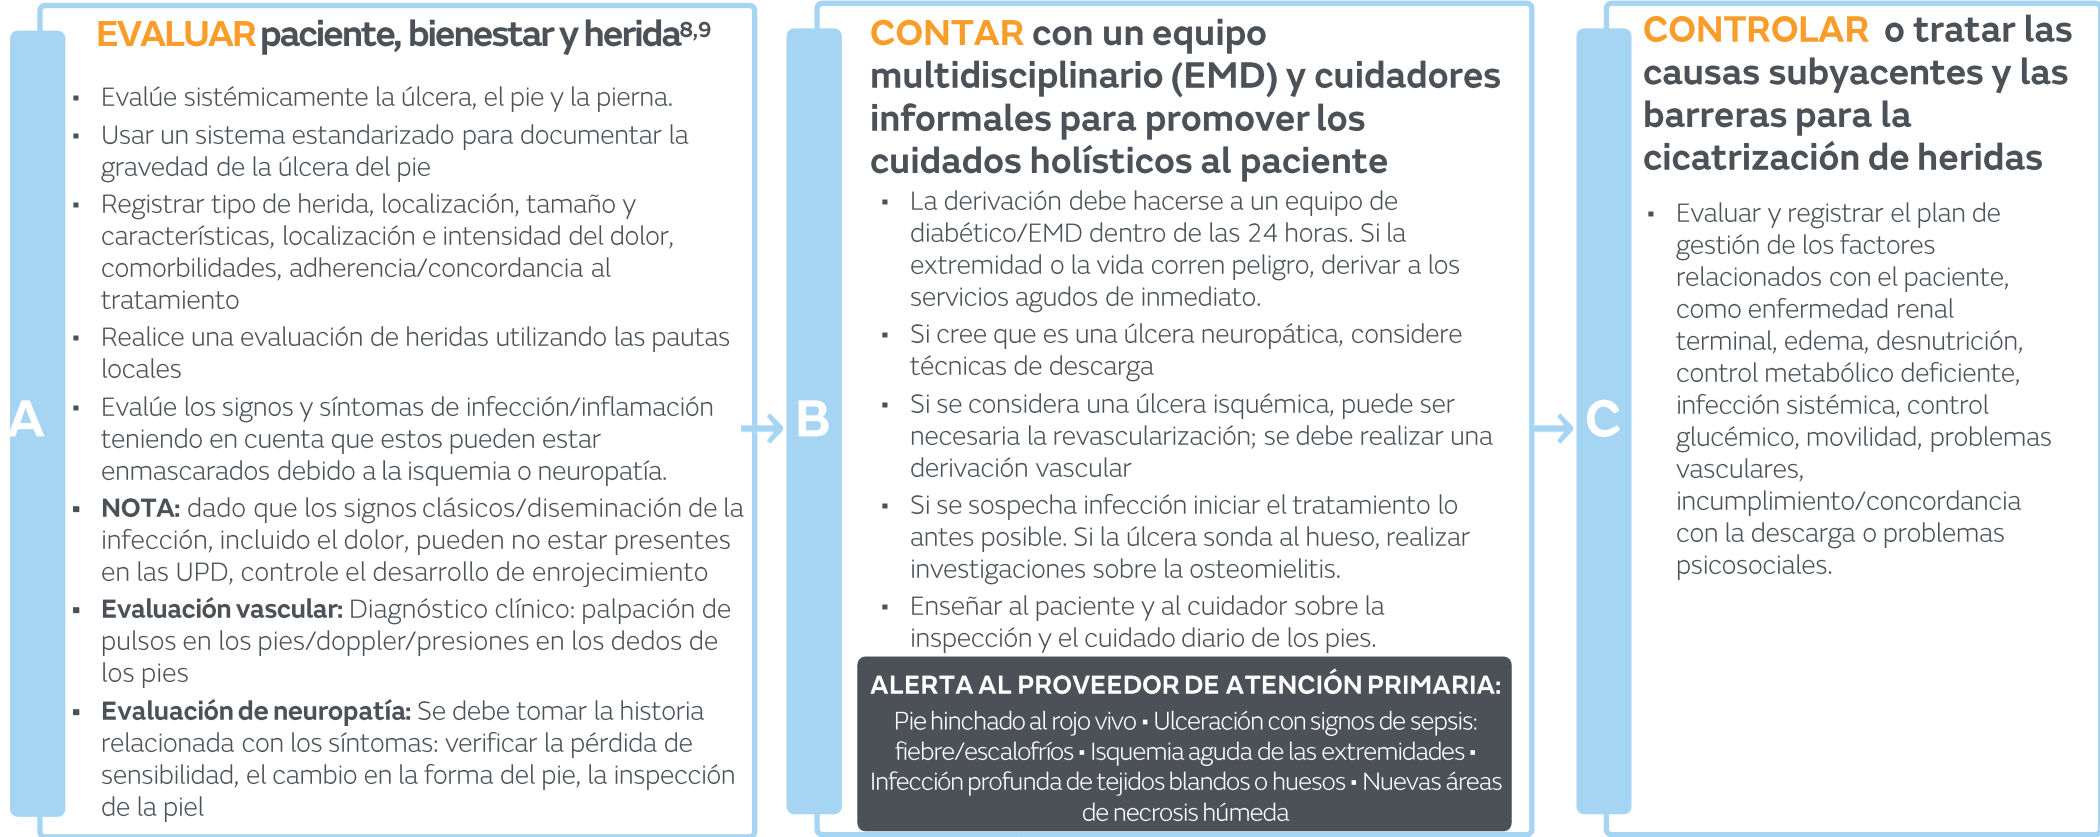

*Usar un apósito secundario apropiado según protocolo local. **Considere si también se requiere desbridamiento del borde de la herida

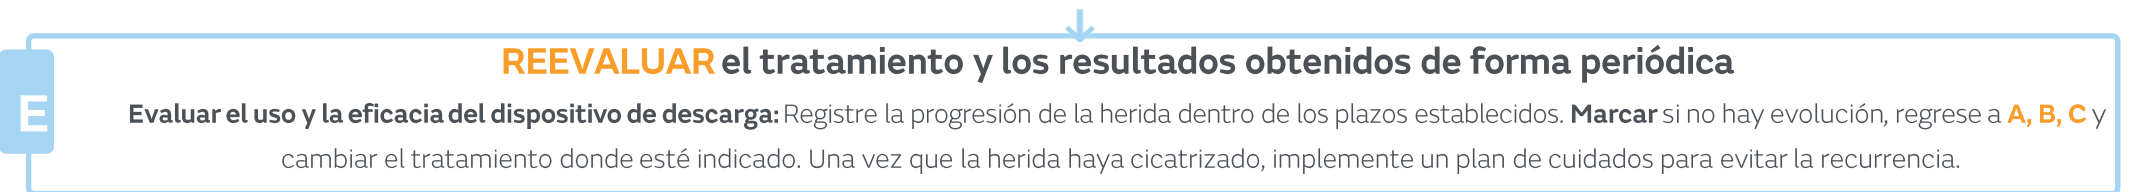

RECOMENDACIÓN: Los clínicos no especialistas en cuidado de heridas necesitan ser capacitados en la Preparación del lecho de la herida T.I.M.E. y cómo llevar a cabo una evaluación integral de heridas. Desarrollado con el apoyo de Glenn Smith³ y Moore et al. 2019⁴

†TPN: Terapia de Presión Negativa. ‡Nivel de exudado para heridas apto para TPN. §La gama SECURA incluye SECURA No-Sting Barrier Film, film barrera no irritante en sus diferentes presentaciones: spray, torundas y toallitas; La gama PROSHIELD incluye PROSHIELD Plus y PROSHIELD Foam & Spray. ¶Cuidado de heridas con biofilm: desbridamiento, limpieza y uso de agente anti-biofilm. ** Desbridar y limpiar y usar un antimicrobiano tópico eficaz según el protocolo local.

Referencias: 1. Schultz GS, et al. Wound Rep Reg (2003);11:1–28. 2. Leaper DJ, et al. Int Wound J 2012; 9 (Suppl. 2):1–19. 3. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International (2016). 4. Weir D, Schultz G. Assessment and Management of Wound-Related Infections. In Doughty D & McNichol L (Eds.). Wound, Ostomy and Continence Nurses Society Core Curriculum: Wound Management (p. 156–180). 2016. Philadelphia: Wolters-Kluwer. 5. Wolcott RD, et al. J Wound Care 2010;19(2):45–53. 6. Schultz G, et al. Wound Repair Regen 2017;25(5):744–757. 7. Ayello EA, et al. Wounds Int 2012;1–24. 8. Smith G, et al. Journal of Wound Care 2010;19(9):396–402. 9. Moore Z, et al. Journal of Wound Care, 2019;28(3):154–161. 10. Dowsett C, et al. Wounds Int. 2020;11(3):20–27.

Los productos utilizados en T.I.M.E. La herramienta de apoyo a la decisión clínica puede variar en diferentes mercados. No todos los productos a los que se hace referencia pueden estar aprobados para su uso o estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante local de Smith+Nephew para obtener más detalles sobre los productos disponibles en su mercado. Destinado únicamente a profesionales de la salud fuera de los EE. UU.

Smith+Nephew no proporciona asesoramiento clínico. La información presentada no es, ni pretende ser, un consejo médico. Para obtener información detallada del dispositivo consulte las instrucciones de uso antes de usarlo. Es responsabilidad de los profesionales de la salud determinar y utilizar los productos apropiados de acuerdo con su propio criterio clínico.

Smith & Nephew S.A.U. Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). T. 902 30 31 60 - F. 902 30 31 70. *Marca registrada de Smith+Nephew. ©Todas las marcas registradas están reconocidas. 29664-es V1 DFU TIME CDST 0423