
# ALLEVYN◊ COMPLETE CARE

## Silikon-Schaumverbände

NEU

Zuverlässiges Exsudatmanagement[1,5,9,10] mit effektivem Bakterien-[8], Proteasen-[25] und Geruchseinschluss[2,3]

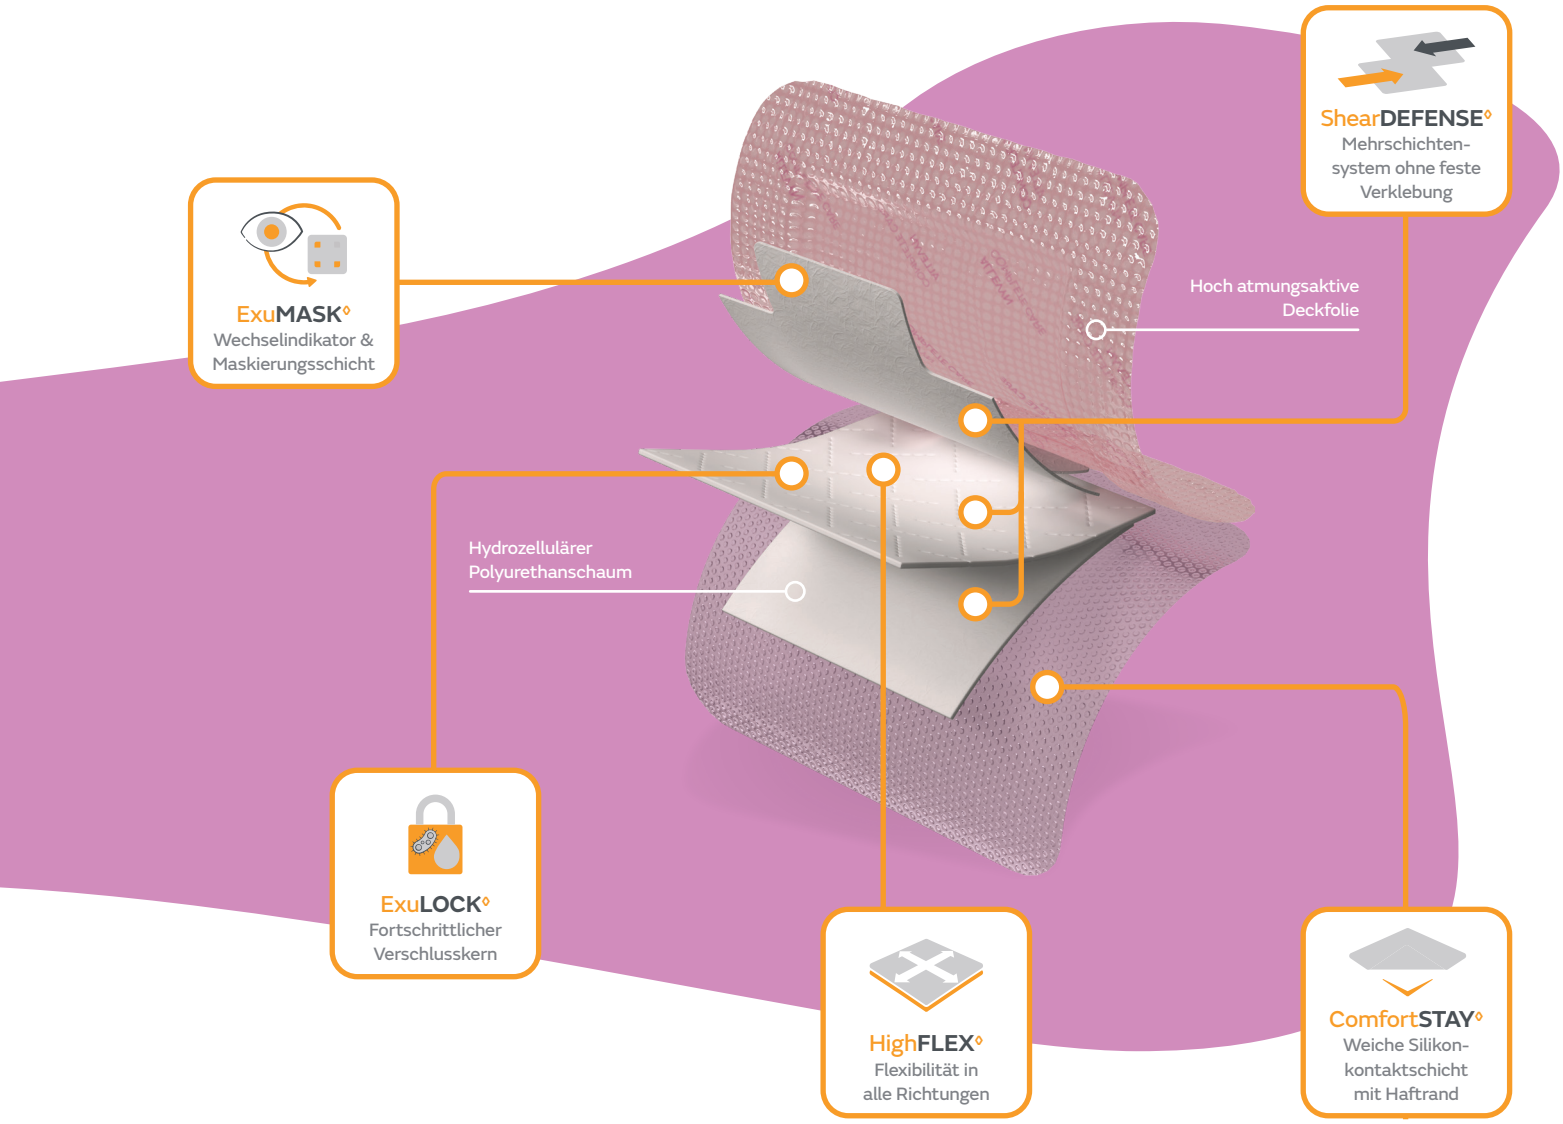


Smith+Nephew

ALLEVYN◊
COMPLETE CARE
Silikon-Schaumverbände

www.smith-nephew.de

SCHWACHE BIS STARKE EXSUDATION

# ALLEVYN◊ COMPLETE CARE: **Ein** Verband mit **Doppelwirkung**


## Exsudatmanagement



**ExuLOCK◊ fortschrittliche Lock-in-Technologie**
- Einschließen von Exsudat und Bakterien selbst unter Kompression[1,8]
- Ermöglicht eine horizontale Verteilung des Exsudats über die gesamte Verbandfläche*[9] und hilft so, Leckagen zu verhindern[2,3]
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu‡ zur Förderung der Heilung [3,5,9,10]

**ExuMASK◊ Technologie des Wechselindikators**
- Reduziert die Sichtbarkeit der Wundflüssigkeit, so dass der Verband länger frisch aussieht. [2,3,9,11–14]
- Zeigt optisch an, wann der Verband zu wechseln ist[11]

Visuelle Anleitung für den ExuMASK Wechselindikator



Wechsel nicht erforderlich | Wechsel erwägen | Wechseln



**ComfortSTAY◊ Technologie mit Haftschicht aus weichem Silikon**
- Sorgt für eine sanfte und sichere Haftung[15–17]
- Ist atraumatisch für Wunde und umliegende Haut und minimiert Schmerzen bei der Entfernung[3,16–18]



**ALLEVYN hochabsorbierende Schaumschicht**
- Langanhaltende vertikale Absorption, um Flüssigkeitsansammlungen und Mazeration zu minimieren[1,3,9]
- Die Porengröße des Schaums ermöglicht das Management von Exsudat mit niedriger bis hoher Viskosität[9]



**Atmungsaktive Außenfolie**
- Schutz vor äußerem Bakterieneintritt‡[19]
- Duschfest[20]

**HighFLEX Multidirektionale Stretch-Technologie**



- Anschmiegsam und flexibel[7,21]
- Passt sich gut an die Körperkonturen an§[3,22]
- Hilft bei der Anwendung an problematischen Bereichen§[3,12,22]

## Prävention von Druckverletzungen




**ShearDEFENSE◊ Technologie mit unverbundenen Schichten**
- Ein spezielles Design mit nicht fest verbundenen Verbandlagen ermöglicht ein kontrolliertes Gleiten der Schichten innerhalb des Verbands*[,4]
- Scherkräfte werden aufgenommen und die Belastung des Weichteilgewebes reduziert*[,4,23], um das Risiko von Druckverletzungen zu minimieren[24]
- Hochwirksame Absorption von Scher- und Reibungskräften‖[,4]



**ComfortSTAY Technologie mit Haftschicht aus weichem Silikon**
- Kann bei gleichbleibender Haftung repositioniert werden, um die Hautkontrolle während der Tragedauer des Verbandes zu erleichtern*[15]



**Atmungsaktive Außenfolie**
- Begünstigt ein optimales Mikroklima[5,10]



**Umverteilung des Drucks**
- sorgt dafür, dass äußerer Druck besser verteilt wird*[6]

## Bestellinformationen

| PZN* | Größe Verband | Größe Wundauflage | Inhalt / OP** | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| **ALLEVYN◊ COMPLETE CARE** | | | | |
| **20178421** | 7,5 × 7,5 cm | 4,5 x 4,5 cm | 10 | 66807695 |
| **20178438** | 10,0 × 10,0 cm | 6,5 x 6,5 cm | 10 | 66807696 |
| **20178450** | 12,5 x 12,5 cm | 8,5 x 8,5 cm | 10 | 66807697 |
| **20178467** | 15,0 × 15,0 cm | 11,0 x 11,0 cm | 10 | 66807698 |
| **20178473** | 17,5 x 17,5 cm | 13,5 x 13,5 cm | 10 | 66807699 |
| **20178527** | 10,0 x 20,0 cm | 5,0 x 15,0 cm | 10 | 66807700 |
| **20178533** | 10,0 × 30,0 cm | 5,0 x 25,0 cm | 10 | 66807701 |
| **ALLEVYN◊ COMPLETE CARE Multisite** | | | | |
| **20178556** | 17,1 x 17,8 cm | 11,5 x 12,3 cm | 10 | 66807702 |
| **ALLEVYN◊ COMPLETE CARE Sacrum** | | | | |
| **20178504** | 17,2 x 17,4 cm | 8,4 x 12,4 cm | 10 | 66807703 |
| **20178510** | 21,5 x 23,0 cm | 12,3 x 16,9 cm | 10 | 66807704 |
| **ALLEVYN◊ COMPLETE CARE Heel** | | | | |
| **20178496** | 25,0 x 25,2 cm | 20,0 x 20,2 cm | 10 | 66807705 |

*Pharmazentralnummer
**Originalpackung



Multisite | Sacrum | Heel (Ferse)

*Wie *in vitro nachgewiesen*. †Wie in silico und *in vitro nachgewiesen*. ‡Während der Tragedauer des Verbands. §ALLEVYN 5-lagige Verbände. ‖Wie in silico nachgewiesen.

**Smith & Nephew GmbH**
Van-der-Smissen-Straße 9
22767 Hamburg
+49 40 87 97 44-0
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

◊Marke von Smith+Nephew
Alle Marken anerkannt
©April 2026 Smith+Nephew
AWM-AWC-47986-de. GMC1944

**Hersteller**
Smith & Nephew GmbH Medical Ltd
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
England

**Referenzen: 1.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. **2.** Tiscar-González V, et al. *Adv Skin Wound Care.* 2021;34(1):23–30. **3.** Rossington A, et al. *Wounds UK.* 2013;9(4):91–95. **4.** Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. **5.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. **6.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. **7.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. **8.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.019 V2. **9.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. **10.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.010. **11.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. **12.** Simon D, Bielby A. *Wounds UK.* 2014;10(3):80–87. **13.** Joy H, et al. *J Wound Care.* 2015;24(7):312, 314–317. **14.** Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023. **15.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.015 V2. **16.** Vowden K, et al. Paper presented at: EWMA ; 2011. **17.** Smith+Nephew. Internal report EA/AWM/GENERAL/001/v2. **18.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN◊ Gentle Border. *Wounds UK.* 2009;5(3):32–44. **19.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.014. **20.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.017. **21.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.013. **22.** Stephen-Haynes J, et al. *Journal of Community Nursing.* 2013;27(5):50–59. **23.** Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.058 V2. **24.** Atkinson L, Costa B. Poster presented at: EWMA; 2024. **25.** Internal report CSD.AWM.25.020. Geri C, et al. J Wound Care. 2025; 34(1): 9 – 16.